




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

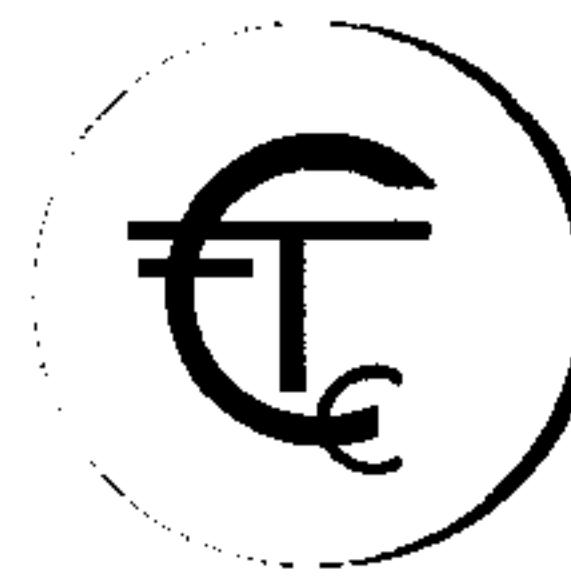

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 4.2.23.1/A4
Τηλ.: 22601661
Φαξ: 22605009

4 Ιανουαρίου 2012

Εγκύλιος ΕΕ «Τ» (306)

Όλο το Τελωνειακό προσωπικό

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας

A) Χειρουργικές ποδιές μιάς χρήσης – Δ.Δ 62101092

B) Χειρουργικά σεντόνια (πετάσματα) μιας χρήσης – Δ.Δ 63079092

—— Σας αποστέλλεται η τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό C 1 ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2012.

Η τροποποίηση αφορά την δασμολογική κατάταξη χειρουργικών ποδιών μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς ή τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και χειρουργικά σεντόνια (πετάσματα) μιας χρήσης από μη υφασμένα υφάσματα της κλάσης 5603, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

(Ευρυδίκη Μυριάνθους)

για Διευθυντή

Τμήματος Τελωνείων

EM/

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy & marios@ccci.org.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: everafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cyη της Ιστοσελίδας
- : και Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

**Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2012/C 1/04)**


Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο⁽¹⁾, οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης⁽²⁾ τροποποιούνται ως εξής:

Σελίδα 245

Η επεξηγηματική σημείωση της διάκρισης **6210 10 90** διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«6210 10 92 Χειρουργικές ποδιές μίας χρήσης, που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς ή τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων»

Οι ποδιές ασθενών και χειρουργών αποτελούν προϊόντα μιας χρήσης που συνήθως κλείνονται στην πλάτη και χρησιμοποιούνται σε θεραπευτήρια, με σκοπό να εμποδίζεται η μετάδοση δυνητικώς μολυσματικών παραγόντων (ξηρών, υγρών ή αερόφερτων) από τη χειρουργική ομάδα στον ασθενή και αντιστρόφως, μέσω άμεσης επαφής. Οι ποδιές αποτελούνται συνήθως από πολλαπλά στρώματα μη υφασμένων υφασμάτων και μπορεί να είναι εν μέρει πλαστικοποιημένες με πλαστική μεμβράνη, η οποία προσδίδει πρόσθετη αντοχή και προστασία σε σημεία που είναι πιθανόν να εκτεθούν σε σωματικά υγρά (π.χ. βραχίονες και κοιλιακή χώρα). Οι ποδιές χειρουργών μπορεί να είναι εμποτισμένες με φθοράνθρακες ή σιλικόνη για τη βελτίωση της απωθητικής ικανότητας.

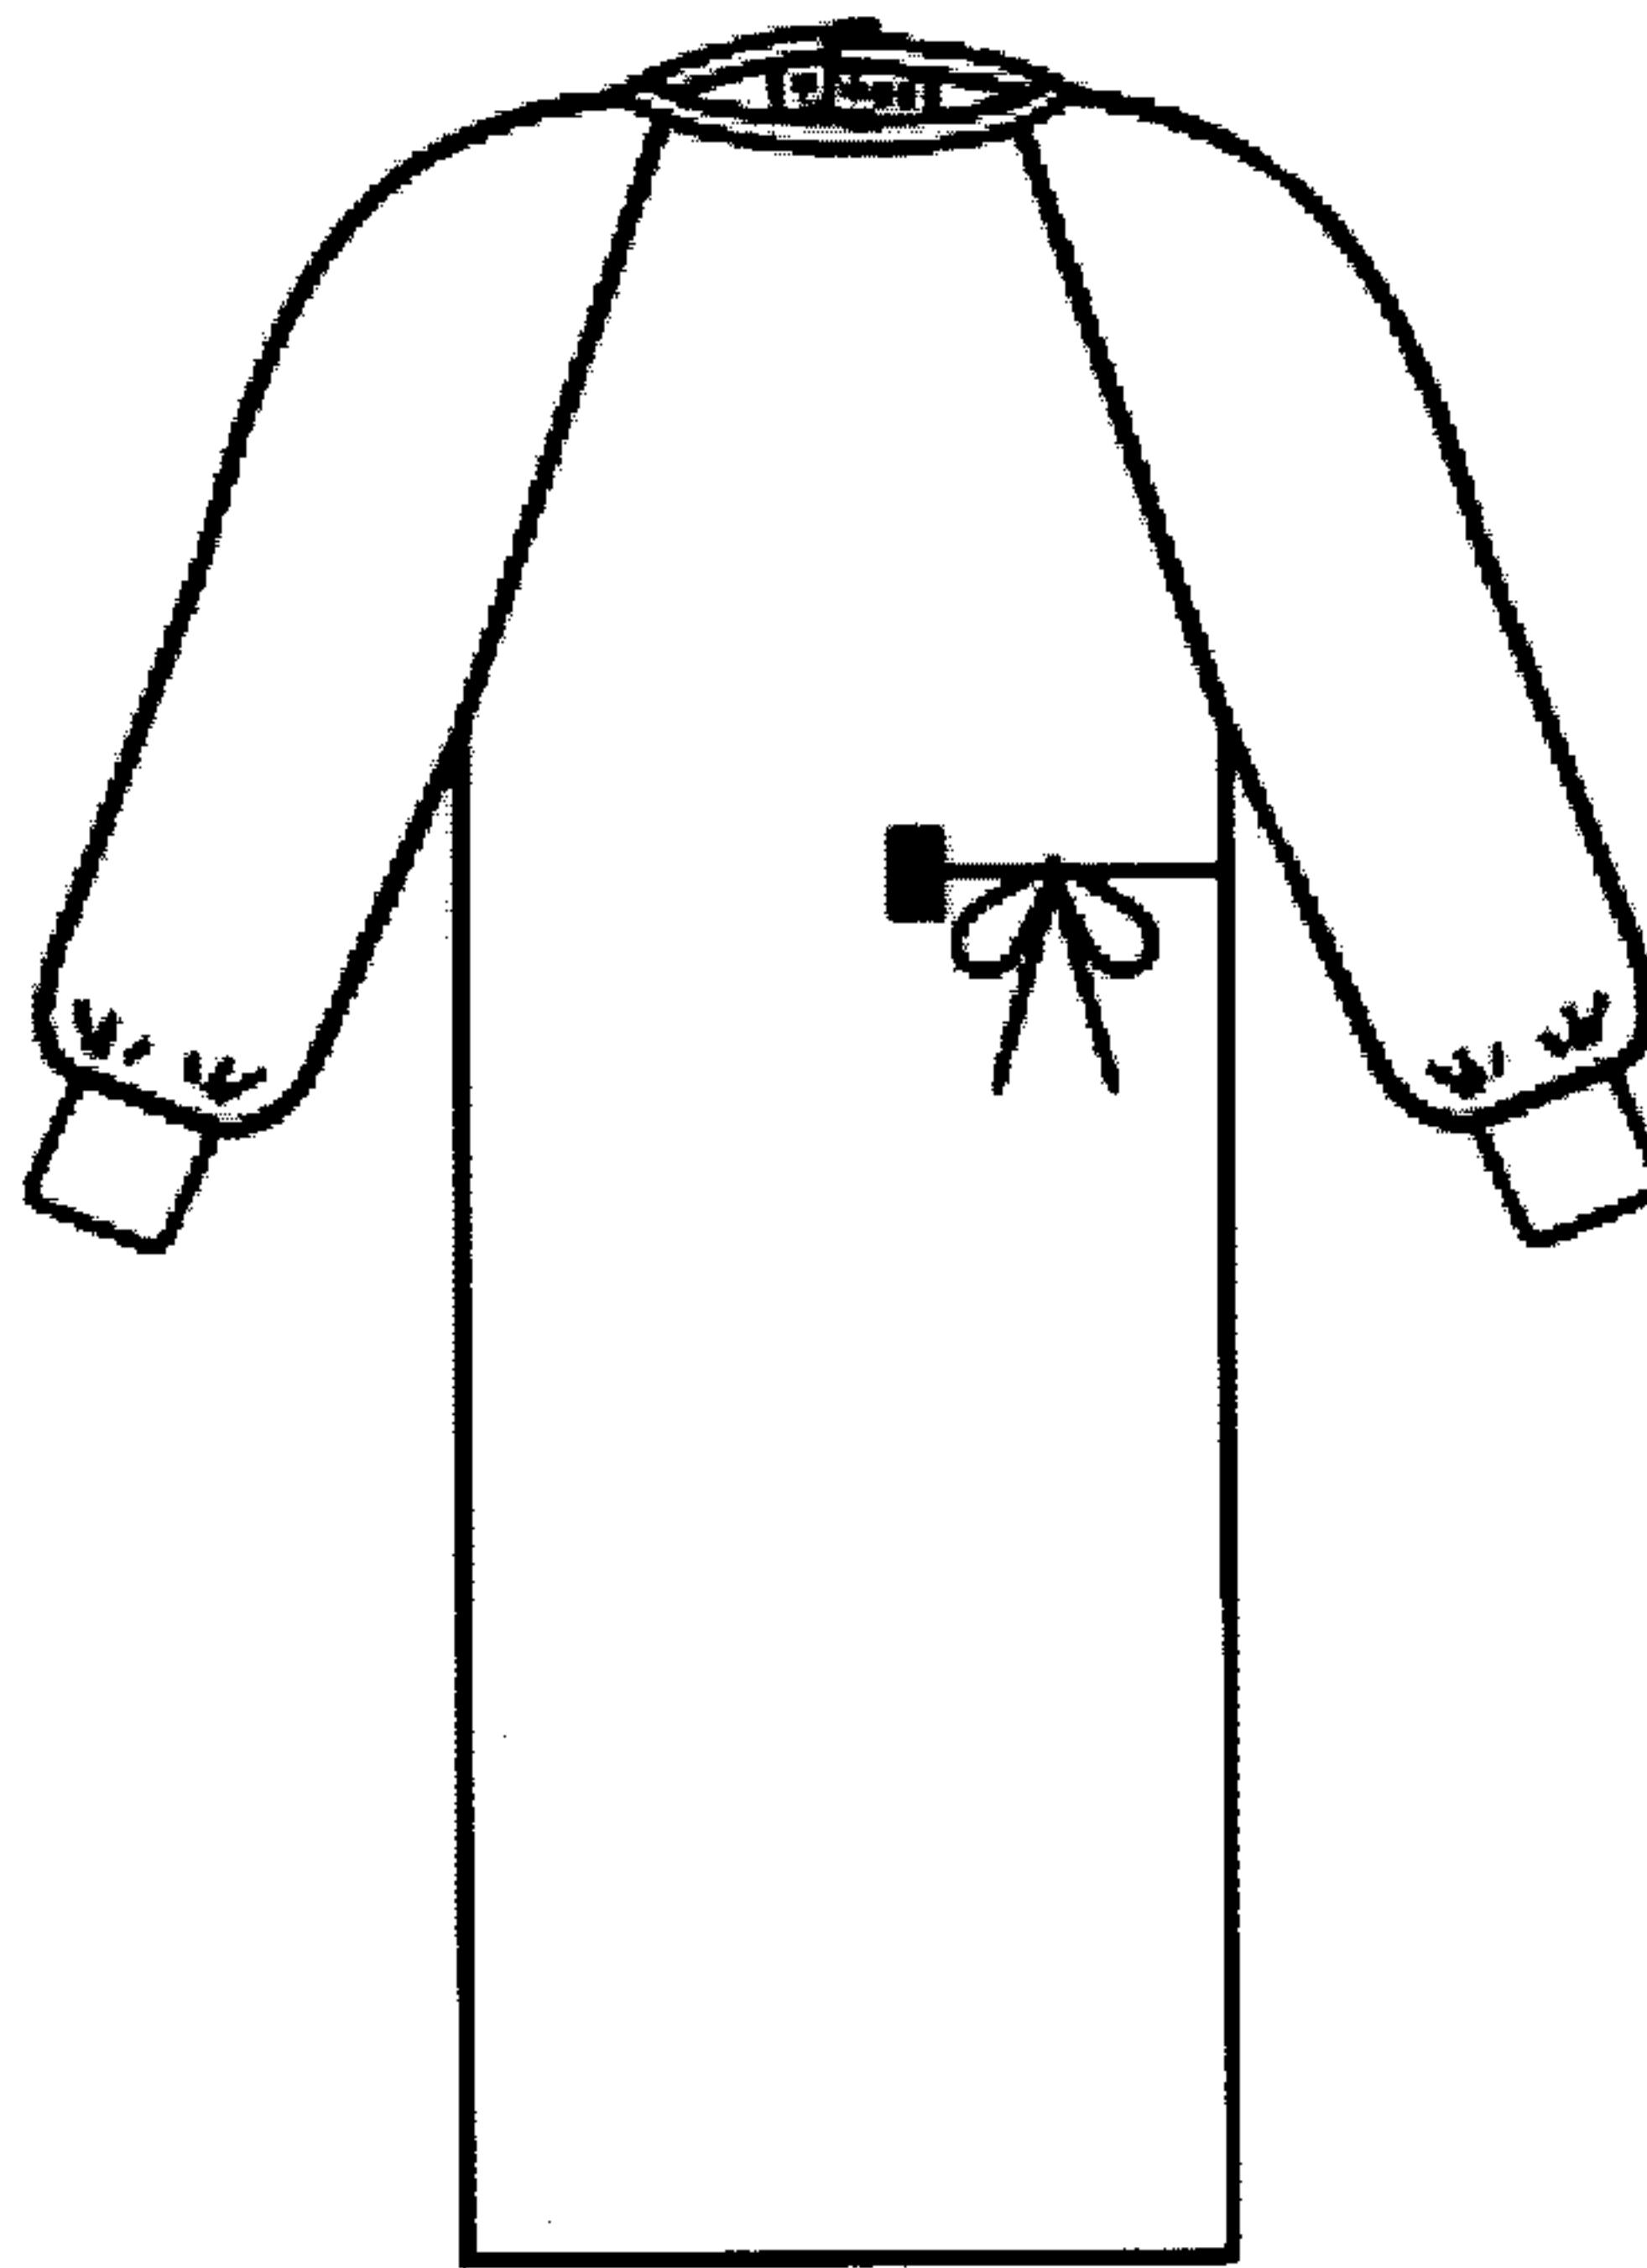

Σελίδα 247

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«6307 90 92 Χειρουργικά σεντόνια (πετάσματα) μίας χρήσης από μη υφασμένα υφάσματα της κλάσης 5603, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων»

Η παρούσα διάκριση περιλαμβάνει χειρουργικά σεντόνια μιας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, ώστε να εμποδίζεται η

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ C 137 της 6.5.2011, σ. 1.

μετάδοση δυνητικώς μολυσματικών παραγόντων (ξηρών, υγρών ή αερόφερτων) από τη χειρουργική ομάδα στον ασθενή και αντιστρόφως, μέσω άμεσης επαφής. Τα χειρουργικά σεντόνια αποτελούνται συνήθως από πολλαπλά στρώματα μη υφασμένων υφασμάτων και κατασκευάζονται με στρίφωμα.

Τα χειρουργικά σεντόνια χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται απαλλαγμένη από μικρόβια περιοχή εργασίας γύρω από τον ασθενή. Μπορεί να είναι εμποτισμένα με φθοράνθρακες ή σιλικόνη για τη βελτίωση της απωθητικής ικανότητας. Μπορεί επίσης να είναι εν μέρει πλαστικοποιημένα με πλαστική μεμβράνη, η οποία προσδίδει πρόσθετη αντοχή και προστασία σε σημεία που είναι πιθανόν να εκτεθούν σε σωματικά υγρά. Επιπλέον, ενδέχεται να καλύπτονται με χαρτί ως στρώμα άνεσης σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς. Τα σεντόνια που χρησιμοποιούνται πάνω σε ασθενείς μπορεί να φέρουν οπές ή ανοίγματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον ασθενή.

Η παρούσα διάκριση δεν περιλαμβάνει:

- σεντόνια εμποτισμένα ή καλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς (κλάση 3005) και
- είδη που έχουν σαφή χαρακτηριστικά πανικών καθαριότητας (π.χ. πετσέτες χεριών ή προσώπου, υφάσματα καθαρισμού προσώπου) ή πανικών κουζίνας, όπως πετσέτες κουζίνας ή ποτηρόπανα (κλάση 6302).»